


携帯電話端末等が病院内医用機器に及ぼす影響について

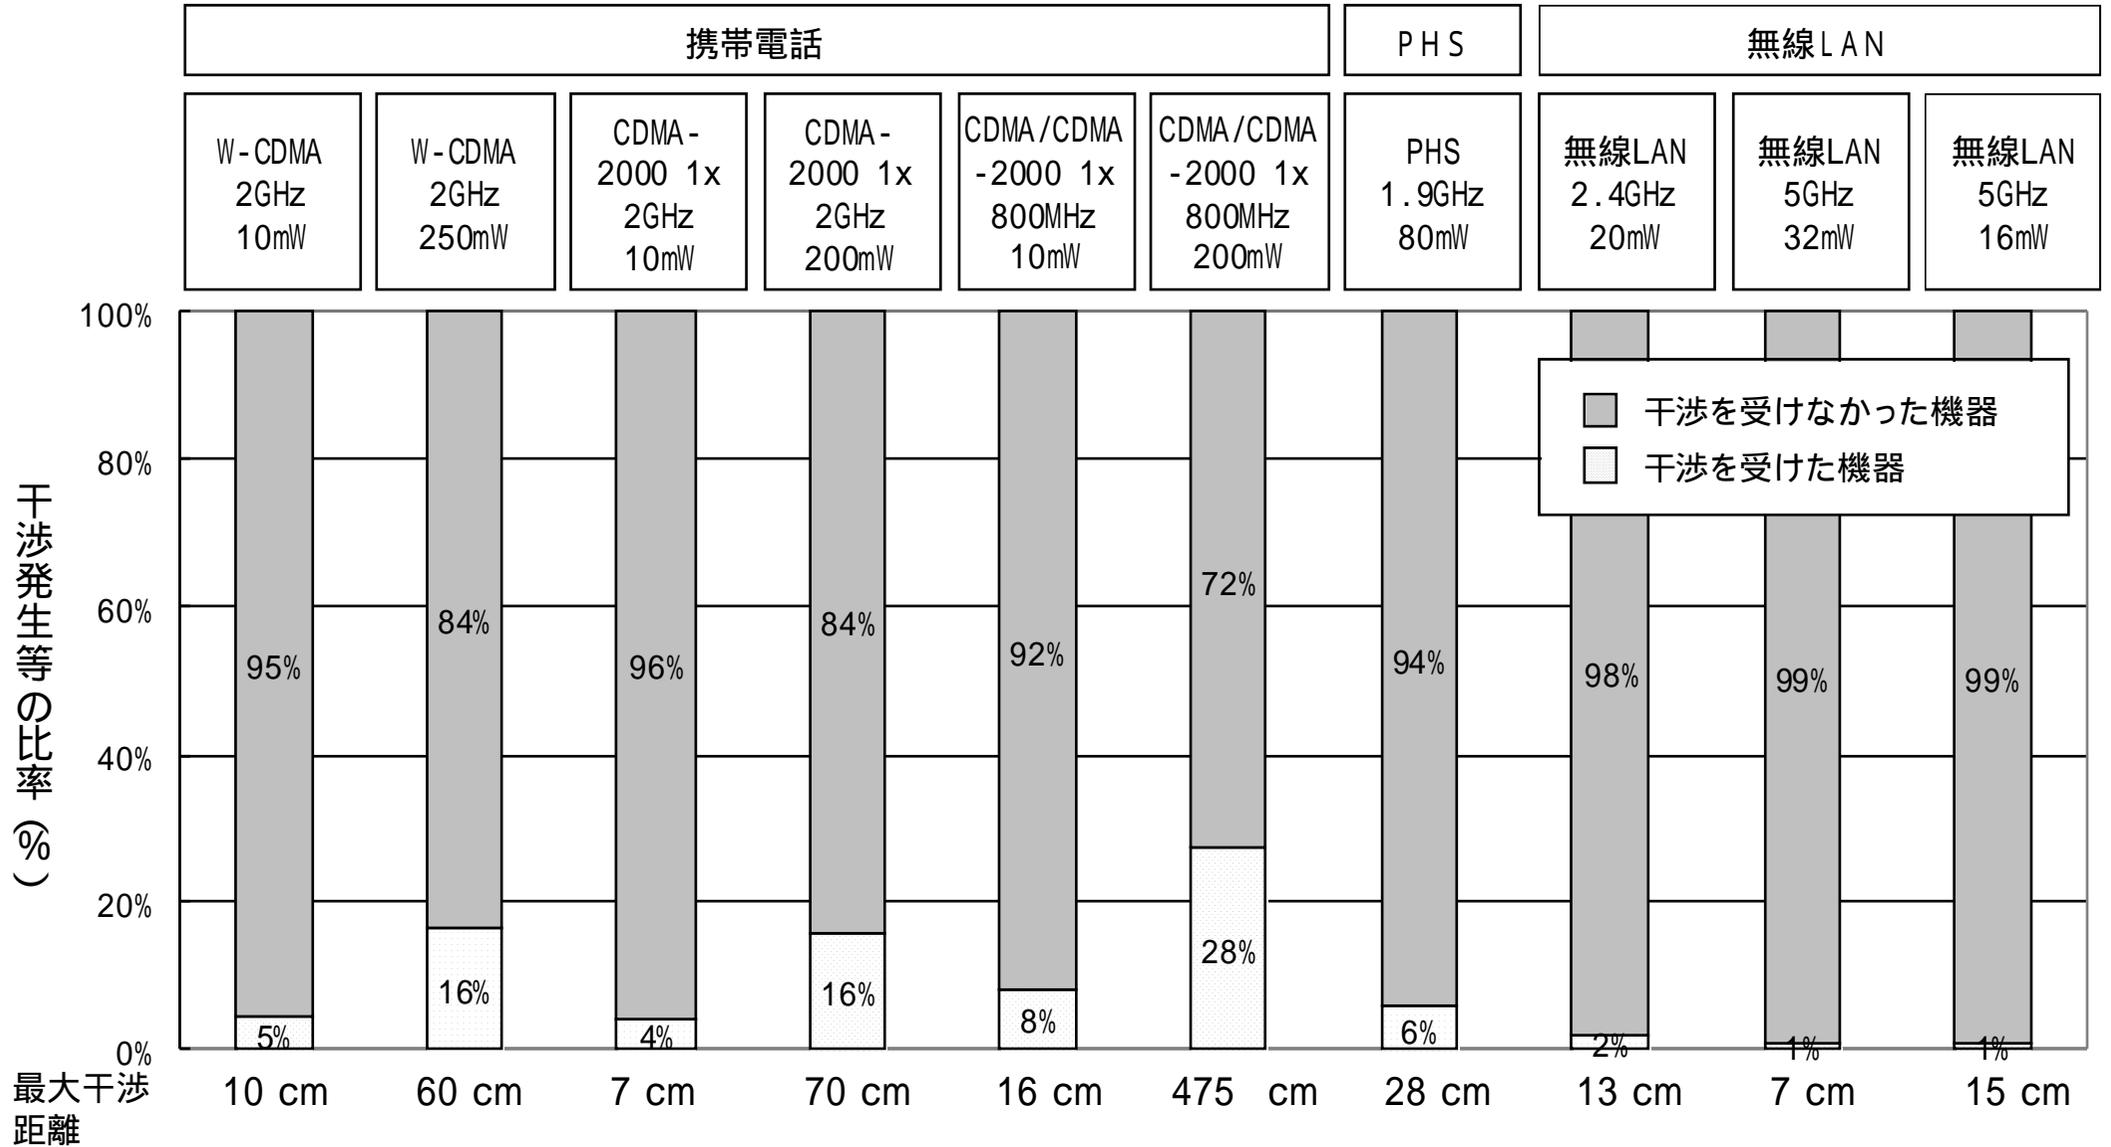

ドプラ胎児診断装置の心拍表示の乱れで軽微な障害である。2番目は180cm(除細動器のモニター波形の小さい乱れ)。

(備考) 調査対象医用機器は、シリンジポンプ、ドプラ胎児診断装置、人工呼吸器、心電図、血圧計、透析装置等 261装置